

フィットチェッカー ONE

付加型適合試験材(ホワイトシリコーン)

GC



より使いやすい 付加型フィットチェッカー

垂れにくい

剥がしやすい

隅々まで広がる



付加型適合試験材(ホワイトシリコーン)

NEW

ジーシー フィットチェッカー ONE



スターターキット

包装・希望医院価格●ベース43g(42mL)1本、キャタリスト57g(42mL)1本、練和紙(No.1)1冊、GC シリコーンリターダー3g1本、少量採取ノズル2個=¥4,650

常に吐出量を
少なくしたい時に

少量採取ノズル

あり なし




補充用1-1キット

包装・希望医院価格●ベース43g(42mL)1本、キャタリスト57g(42mL)1本、練和紙(No.1)1冊=¥4,190

付属品一覧

	練和紙 (No.1)	GC シリコーン リターダー	少量採取 ノズル
スターターキット	○	○	○
補充用1-1キット	○		

別売

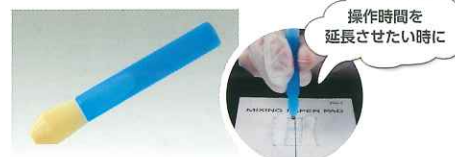

操作時間を
延長させたい時に


GC シリコーンリターダー

包装・希望医院価格●3g1本=¥460

※ 滴下量はジーシーホームページの製品Q&Aをご確認ください。

義歯、クラウン・ブリッジの適合確認に

盛りあげやすく、しっかり広がる

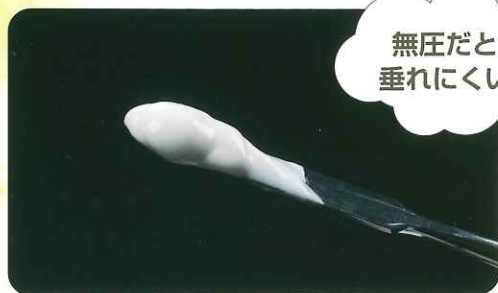

無圧だと
垂れにくい



圧をかけると
広がる


顎模型上で圧接

厚みを識別しやすい



適度な透明性で、微妙な厚みの違いが容易に識別できます。

練和完了がわかりやすい

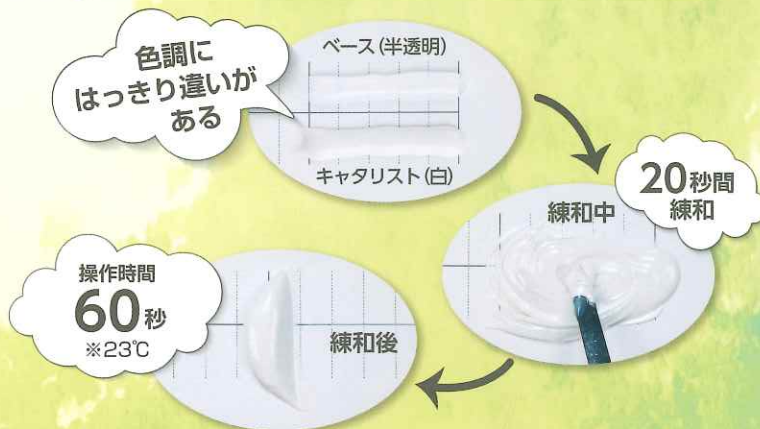

色調に
はっきり違いが
ある

ベース (半透明)

キャタリスト (白)

20秒間
練和

練和中

練和後

操作時間
60秒
※23℃

臨床例



1 完成義歯の口腔内試適を行ったところ、患者さんから右側舌側部に疼痛の訴えがあった。



2 フィットチェッカー ONE を用いて適合確認。



3 義歯を口腔内に挿入し、支台装置を適合させた状態で保持。



4 顎舌骨筋線部に強圧部が認められるため、リリーフが必要と判断。



5 マーキングし、フィットチェッカー ONE を義歯から剥がす。



6 床内面の強圧部位を削合。

※掲載情報は2022年1月現在のものです。
※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※色調は印刷のため現品と若干異なることがあります。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー / 製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号 東京都板橋区蓮沼町76番1号

カスタマーサービスセンター
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京 (03)3813-5751 ●大阪 (06)4790-7333
営業所
●北海道 (011)729-2130 ●名古屋 (052)757-5722
●東北 (022)207-3370 ●九州 (092)441-1286

iPhoneもAndroidも



ジーシー
公式アプリ



どちらもコチラのQRでOK!
推奨OSバージョンはiOS:12.4以上、Android:8.0以上です。